

PŘIHLÁŠKA VYNÁLEZU

zveřejněná podle § 31 zákona č. 527/1990 Sb.

(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(22) Přihlášeno: **18.07.2011**

(40) Datum zveřejnění přihlášky vynálezu: **01.08.2012**
(Věstník č. 31/2012)

(21) Číslo dokumentu:


2011-433

(13) Druh dokumentu: **A3**

(51) Int. Cl.:

G01B 5/02 (2006.01)
G01B 3/10 (2006.01)
G01B 5/08 (2006.01)
A61B 5/107 (2006.01)
A41H 1/02 (2006.01)

- (71) Přihlašovatel:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín, CZ
- (72) Původce:
Smolka Petr Ing. Ph.D., Březolupy, CZ
Chmelařová Martina Ing. Ph.D., Zlín, CZ
Hlaváček Petr Doc. Ing. CSc., Zlín, CZ
Gřešák Václav Ing., Zlín, CZ
Minařík Antonín Ing. Ph.D., Zlín - Želechovice, CZ
- (74) Zástupce:
UTB ve Zlíně, Univerzitní institut, Ing. Dana Kreizlová,
nám. T.G. Masaryka 5555, Zlín, 76001

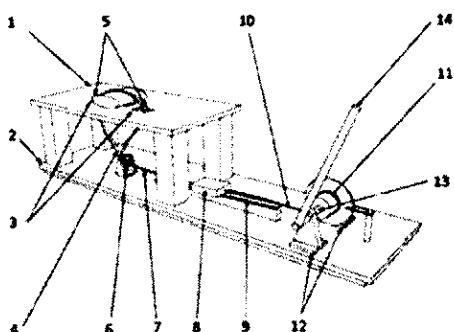

(54) Název přihlášky vynálezu:
**Zařízení pro měření obvodové deformace
stlačitelných těles, zejména chodiřel, v
závislosti na zatížení**

(57) Anotace:
Zařízení je tvořeno zkusebním stolem (1) uchyceným na základové plošině (2) a opatřeným štěrbinou (3) s měřicí pákou (4), vyčnívající ve tvaru smyčky ze štěrbiny (3) nad plochou zkusebního stolu (1), přičemž měřicí páška (4) je dále vedena přes horní kladku (5) otočně uchycené ve štěrbině (3) zkusebního stolu (1) a přes dolní kladku (6) otočně uchycenou na základové plošině (2). Zde je měřicí páška (4) spojena s korekčním mechanismem (7), napojeným na snímač (8) síly, pohyblivě uložený na kolejnici (9), odkud je vedeno lanko (10) na navijecí váleček (11) otočně uchycený k základové plošině (2) prostřednictvím nosných konzol (12) a hřidele (13). Ke hřidle (13) je v kolmém směru k ose hřidele (13) uchycena napínací páka (14). Ve výhodném provedení zařízení podle vynálezu jsou hodnoty deformace i napětí odečítány elektronicky pomocí digitální kamery (15) a interaktivního snímače (16) síly, propojených s počítačem (17).

18.07.11

PZ 2011-1453

Zařízení pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel, v závislosti na zatížení

Oblast techniky


Vynález se týká zařízení schopného měřit obvodovou deformaci chodidel a jiných stlačitelných těles v závislosti na zatížení. Toto zařízení je určeno především pro obuvnický průmysl.

Dosavadní stav techniky

Většina prostředků pro měření deformace chodidel, které jsou užívány v obuvnickém průmyslu, je založena na principu ručního měření. Vychází z klasického měření nohou pomocí plátěného obuvnického měřidla (analogie krejčovského měřidla). Všechny tyto prostředky a zařízení měří skutečný obvodový rozměr nohy v odlehčení i zatížení.

Podstata měření je následující: plátěné obuvnické měřidlo je přiloženo tak, že tvoří uzavřený okruh kolem měřeného tělesa – chodidla – při zatížení vlastní vahou stojící osoby. Číselná hodnota obvodu chodidla je odečtena z vyznačených dílků dle překrytí s počátkem měřidla. Při tomto měření není záměrem, aby na chodidlo byla měřidlem vyvíjena tahová nebo tlaková síla. Přesto se výsledky při jednotlivých měřeních téhož chodidla, zejména prováděných různými osobami, od sebe poněkud liší. Je to způsobeno lidským faktorem – těsné přiložení měřidla je někdy spojeno s mírným utažením, které však není žádným způsobem snímání. Tak vznikají těžko odstranitelné nepřesnosti v hodnotách obvodu chodidla. Navíc zde není možno aktivně působit na chodidlo například danou tahovou silou a měřit deformaci chodidla v závislosti na tomto přídavném zatížení. Na druhé straně právě tento faktor je velmi důležitý z hlediska obuvnického průmyslu.

Podobně jako právě uvedené měření je prováděno měření obvodu chodidla pomocí svinovacího metru. Svinovací, v tomto případě samonavíjecí metr je vyroben z textilního pásku s navinovacím zařízením v transportní krabičce. Číselná hodnota je opět odečtena z dílků vyznačených na pásce. Při tomto měření působí páska na chodidlo velmi malou, téměř nulovou tahovou silou, kterou vyvazuje pružina uvnitř transportní krabičky. Tahová síla je tedy konstantní a navíc téměř zanedbatelná. Proto je vznik nepřesnosti oproti předchozí technice měření podstatně omezen, ani zde však není zcela vyloučen. Aretace měřicí pásky stejně jako u předchozího provedení zcela chybí. Především však ani zde není možno cíleně působit na obvod chodidla definovanou tahovou silou měřicí pásky a stanovit tak závislost deformace chodidla na tomto působení.



Z patentovaných řešení na toto téma lze uvést patent US 4,974,331, který popisuje zařízení k měření obvodu tělesa, vybavené sadou měřicích pásek, které při měření přiléhají k obrysu tělesa díky mírnému tahu navijecí pružiny. Jde tedy o vícenásobnou aplikaci právě uvedeného principu měření s tím, že obvod je měřen v několika místech současně a přesnost měření je v relaci s možnostmi tohoto zařízení. Ani zde však není vybavení k tomu, aby byla intenzivním působením měřicí pásky vyvolána deformace a sledována její závislost na působící síle.

Podstata vynálezu

Uvedené nevýhody a nedostatky dosud známých systémů pro měření obvodového rozměru chodidel při zatížení do značné míry odstraňuje zařízení pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel, v závislosti na zatížení, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je tvořeno zkušebním stolem uchyceným na základové ploše a opatřeným štěrbinou s měřicí páskou, vyčnívající ve tvaru smyčky ze štěrbiny nad plochu zkušebního stolu. Měřicí páška je dále vedena přes horní kladky otočně uchycené ve štěbině zkušebního stolu a přes dolní kladku otočně uchycenou na základové ploše, kde je měřicí páška spojena s korekčním mechanismem, napojeným na snímač síly, pohyblivě uložený na kolejnici. Odtud je vedeno lanko na navijecí váleček otočně uchycený k základové ploše prostřednictvím nosných konzol nesoucích hřídel, k němuž je v kolmém směru k ose hřidele uchycena napínací páka.

Zařízení podle vynálezu je s výhodou vybaveno digitální kamerou a interaktivním snímačem síly, propojenými s počítačem.

Hlavní předností zařízení podle vynálezu oproti dosud známým technikám a prostředkům, zejména určeným pro měření chodidel, je skutečnost, že toto zařízení umožňuje nejen pouhé studium rozměrů chodidla, ale i studium deformační odezvy chodidla nebo jiného předmětu na proměnné zatížení.

Přehled obrázků na výkresech

Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech, představujících toto zařízení v prostorovém pohledu s viditelnými všemi funkčními částmi. Na obr. 1 je základní provedení zařízení, na obr. 2 pak je znázorněno výhodné provedení, které navíc obsahuje členy umožňující elektronický a kontinuální odečet hodnot obou sledovaných veličin.

Příklad provedení vynálezu

Příklad 1

Z přiloženého výkresu – obr. 1 – lze vidět, že pracovní částí zařízení je zkušební stůl 1, instalovaný na základové plošině 2 a opatřený štěrbinou 3, z níž ve tvaru smyčky vyčnívá měřicí pánska 4 nad plochu zkušebního stolu 1. Měřicí pánska 4 je dále vedena přes horní kladky 5 otočně uchycené ve štěrbině 3 zkušebního stolu 1 a přes dolní kladku 6 otočně uchycenou na základové plošině 2. Zde je měřicí pánska 4 spojena s korekčním mechanismem 7, napojeným na snímač 8 síly, který je pohyblivě uložen na kolejnici 9. Odtud je vedeno lanko 10 na navijecí váleček 11 otočně uchycený k základové plošině 2 prostřednictvím nosných konzol 12 nesoucích hřídel 13. Ke hřídeli 13 je v kolmém směru k ose hřídele 13 uchycena napínací páka 14.

Toto zařízení pracuje tak, že proband se postaví na zkušební stůl 2 a jeho chodidlo je v oblasti kloubu palce a malíku vsunuto do smyčky měřicí pásky 4 s metrickou stupnicí tak, aby měřicí pánska 4 těsně, ale bez napětí přilehla k obvodu chodidla. Měřicí pánska 4 je pak přes horní kladky 5 a přes dolní kladku 6, dále přes korekční mechanismus 7 se snímačem 8 síly a dále prostřednictvím lanka 10 tažena směrem na navijecí váleček 11 nesený hřídelem 13. Napínací páka 14 otáčí hřídelem 13 a navíjením lanka 10 vyvolá tahovou sílu na navazující měřicí pásku 4, čímž dochází k utahování smyčky kolem chodidla probanda a vyvolání deformace chodidla. Zároveň se ale tahová síla odpovídající deformaci zobrazuje na snímači 8 síly. Tak je možno obdržet závislost deformace chodidla na zatížení tahem měřicí pásky.

Zařízení podle vynálezu takto umožňuje studium odezvy chodidla na proměnlivé zatížení. Cílem experimentu je vyhodnotit odezvu nohy na jednotlivá zatížení, tj. o kolik mm se zmenšíl obvod chodidla oproti počáteční hodnotě například při zatížení 5, 10, 20, ... N. Zařízení je koncipováno tak, aby obsluha měla v každém okamžiku volné ruce a mohla si zaznamenávat údaje z přístroje - utažení měřicí pásky 4 a zatěžující sílu zobrazenou na snímači 8 síly.

Příklad 2

Na obr. 2 je znázorněno výhodné provedení zařízení podle vynálezu, které je oproti příkladu 1 navíc vybaveno digitální kamerou 15 a interaktivním snímačem 16 síly, přičemž obě tyto součásti jsou propojeny s počítačem 17. Vizuální odečet sledovaných hodnot deformace a působící síly je tak nahrazen přesnějším odečtem elektronickým s možností

kontinuálního zachycení korelace síla – deformace. Tím se značně zvyšuje dosažitelná přesnost, ale i komfort měření.

Průmyslová využitelnost

Zařízení, určené pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel, podle vynálezu, je využitelné v prvé řadě při navrhování a konstrukci běžné i speciální obuvi. Alternativní využití pak nalezně všude tam, kde je třeba měřit deformaci resp. zmenšení obvodového rozměru předmětu při daných hodnotách zatížení.

5

PV 2041-453

Seznam vztahových značek:

- 1 – zkušební stůl
- 2 – základová plošina
- 3 – štěrbina
- 4 – měřicí páска
- 5 – horní kladky
- 6 – dolní kladka
- 7 – korekční mechanismus
- 8 – snímač síly
- 9 – kolejnice
- 10 – lanko
- 11 – navijecí váleček
- 12 – nosná konzola
- 13 – hřídel
- 14 – napínací páka
- 15 – digitální kamera
- 16 – interaktivní snímač síly
- 17 – počítač


PATENTOVÉ NÁROKY

1. Zařízení pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel v závislosti na zatížení, vyznacující se tím, že je tvořeno zkušebním stolem (1) uchyceným na základové ploše (2) a opatřeným štěrbinou (3) s měřicí páskou (4), vyčnívající ve tvaru smyčky ze štěrbiny (3) nad plochu zkušebního stolu (1), přičemž měřicí pásek (4) je dále vedena přes horní kladku (5) otočně uchycené ve štěrině (3) zkušebního stolu (1) a přes dolní kladku (6) otočně uchycenou na základové ploše (2), kde je měřicí pásek (4) spojena s korekčním mechanismem (7), napojeným na snímač (8) síly, ~~pohybující se po~~ ^{pohyblivě uložený na} kolejnici (9), odkud je vedeno lanko (10) na navíjecí váleček (11) otočně uchycený k základové ploše (2) prostřednictvím nosných konzol (12) a hřidele (13), k němuž je v kolmém směru k ose hřidele (13) uchycena napínací páka (14). mo 10
2. Zařízení pro měření deformace podle nároku 1, vyznacující se tím, že je vybaveno digitální kamerou (15) a interaktivním snímačem (16) síly, propojenými s počítačem (17).

Obr. 1

1/2

PV 2011-433

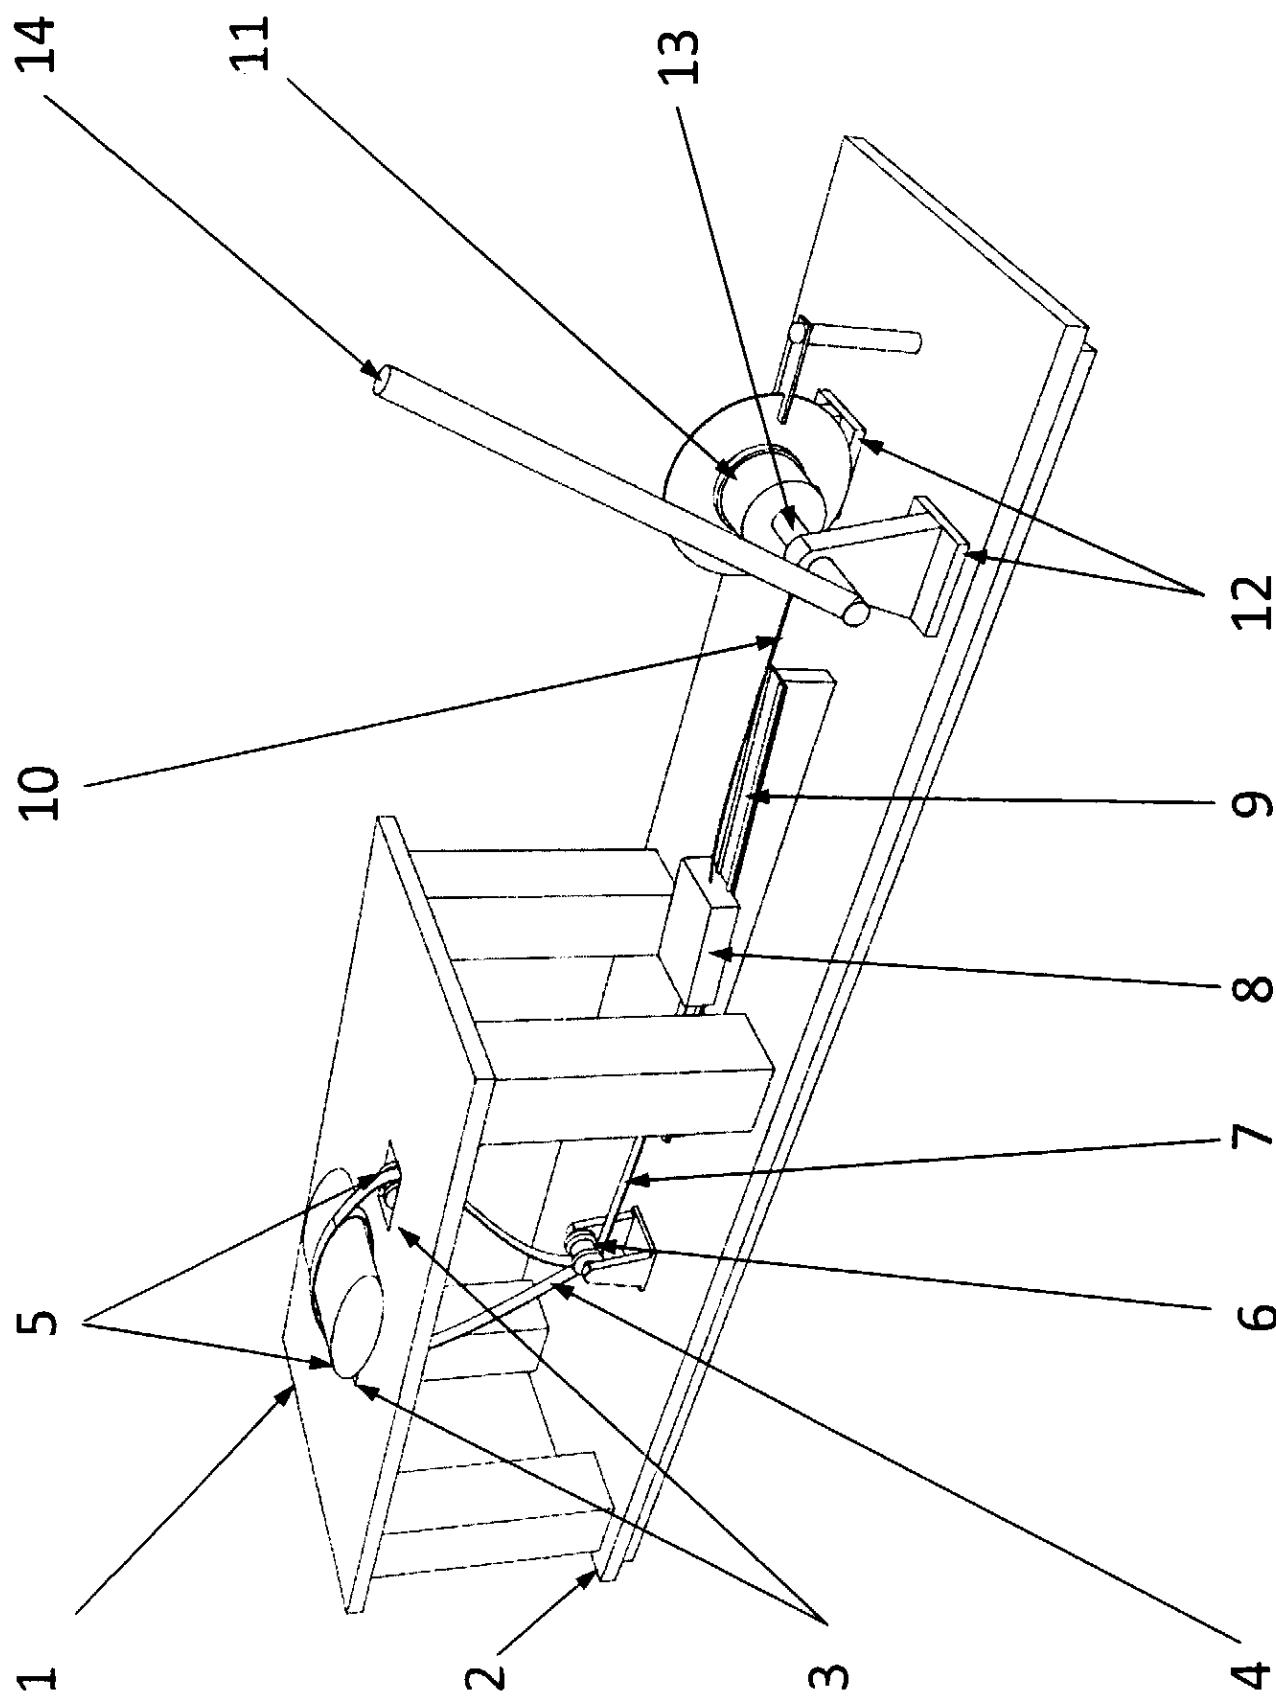

Obr. 2

2/2

10.07.11

PV 2011-433

